

ICS 号:

CCS 号:

# 团 体 标 准

T/CIFST XXX.3—XXXX

## 食品及食品生产过程中食品致敏原 的免疫分析检测方法 第 3 部分：蛋类

Detection of food allergens in foods and during the food  
production process using Immunoassay method  
Part 3:Eggs

(征求意见稿)

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

中国食品科学技术学会 发 布

## 前 言

T/CIFST XXX 《食品及食品生产过程中食品致敏原的免疫分析检测方法》由下列 17 部分组成：

- 第 1 部分：麸质
- 第 2 部分：甲壳纲类动物
- 第 3 部分：蛋类
- 第 4 部分：花生
- 第 5 部分：大豆
- 第 6 部分：乳
- 第 7 部分：酪蛋白
- 第 8 部分： $\beta$ -乳球蛋白
- 第 9 部分：扁桃仁
- 第 10 部分：腰果
- 第 11 部分：榛子
- 第 12 部分：巴西坚果
- 第 13 部分：椰子
- 第 14 部分：夏威夷果
- 第 15 部分：开心果
- 第 16 部分：核桃
- 第 17 部分：芝麻

本文件为 T/CIFST XXX 的第 3 部分。

本文件按照 GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国食品科学技术学会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 食品及食品生产过程中食品致敏原的免疫分析检测方法

## 第 3 部分：蛋类

### 1 范围

本部分规定了食品及食品生产过程中蛋类致敏原的酶联免疫吸附和免疫层析测定方法。

本部分适用于食品中蛋类致敏原的酶联免疫吸附定量检测和免疫层析定性检测，也适用于食品生产过程中监控蛋类致敏原时食品和环境采样及 CIP 清洁水的定量或定性检测。其中，酶联免疫法适合于食品检测；免疫层析法适合于食品、环境采样和 CIP 清洁水检测。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

#### 3.1

蛋 egg

禽蛋是完整的具体生命的活卵细胞，主要包括蛋壳、蛋膜、蛋白和蛋黄四部分。蛋白和蛋黄是可食用性的物质，具有致敏性。

### 第一法 酶联免疫吸附法

### 4 原理

标准溶液及试样中游离的蛋类致敏原被微孔中预先包被的蛋类致敏原特异性抗体捕获，形成抗原-抗体复合物。加入过氧化物酶标记抗体后，形成酶标记抗体-抗原-抗体夹心复合物。再次洗板后，加入底物/发色剂呈显色反应，反应结束后加入终止液终止反应。通过测定 450 nm 波长下吸光度值，蛋类致敏原含量与吸光度值成正比，可得出试样中蛋类致敏原含量。

### 5 试剂和材料

## 5.1 RIDASCREEN® Egg<sup>1</sup> 蛋类致敏原酶联免疫吸附检测试剂盒

见附录 A。

## 5.2 食品中蛋类致敏原提取试剂

除特别说明外，所有试剂均为分析纯或生化试剂，水为 GB/T 6682 规定的三级水。

5.2.1 5 mol/L 盐酸（HCl）：取 42 mL 37% 的浓盐酸，加水定容至 100 mL。

5.2.2 1 mol/L 氢氧化钠（NaOH）：称取 40.00 g NaOH，溶解于 1L 水中。

5.2.3 食品级脱脂奶粉（不含蛋类致敏原）。

## 6 仪器和设备

6.1 酶标仪：450 nm。

6.2 分析天平：感量 0.01 g。

6.3 涡旋混匀仪。

6.4 冷冻离心机：转速不低于 4000 r/min，可实现温度不高于 4℃。

6.5 水浴锅：37℃，60℃。

6.6 单道移液器：20 μL~200 μL，100 μL~1000 μL。

6.7 八道移液器：30 μL~300 μL。

## 7 分析步骤

### 7.1 试剂配制

配制试剂前，将附录 A 中所有试剂回复至室温（20℃~25℃），使用完尽快放置 2℃~8℃，不可冷冻。未使用的微孔板孔，必须与袋中的干燥剂一起，重新放入铝箔封口袋中并封好，放置 2℃~8℃ 保存。

7.1.1 1×洗涤缓冲液：按照 1:10 比例稀释试剂盒中 10×洗涤缓冲液浓缩液（用水见附录 A），稀释后的 1×洗涤缓冲液可贮于 2℃~8℃ 下保存 4 周。如移取 10 mL 10×洗涤缓冲液浓缩液（见附录 A），加 90 mL 水稀释混匀。1 条微孔需约 15 mL 1×洗涤缓冲液洗涤。

7.1.2 1×致敏原提取缓冲液：按照 1:10 比例稀释试剂盒中 10×致敏原提取缓冲液浓缩液（用水见附录 A），稀释后的 1×致敏原提取缓冲液可贮于 2℃~8℃ 下保存 12 周。稀释前，若 10×致敏原提取缓冲液浓缩液（见附录 A）中有结晶，则先将其置于 37℃ 水浴中温育并摇晃混匀，直至结晶完全消失。

7.1.3 蛋类致敏原提取剂：取 25 mL 试剂盒中的提取剂 4，向其中加入 0.50 g ECO 环保添加剂（见附录 A），涡旋振荡直至彻底溶解并混合均匀，可用于提取大约 25 个试样。

7.1.4 含添加剂 1 的致敏原提取缓冲液：称取 1.35 g 添加剂 1（见附录 A），溶解于 15 mL 1 mol/L 氢氧化钠（NaOH）（5.2.2）中，搅拌直至完全溶解。将此溶液完全转移至 700 mL 1×致敏原提取缓冲液（7.1.2）中，用 5 mol/L 盐酸（HCl）（5.2.1）约 1 mL 调节 pH 值至 9，再用 1×致敏原提取缓冲液（7.1.2）定容至 750 mL。配置好的 750 mL 含添加剂 1 的 1×致敏原提取缓冲液，可用于提取约 39 个试样，可在室温（20℃~25℃）条件下保存 3 周，不可冷藏，若出现晶体析出情况则即刻弃用。灰尘会导致晶体的析出，请在配置过程中使用洁

<sup>1</sup> RIDASCREEN® Egg 是由 R-Biopharm 拜发公司提供的产品的商品名。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对该产品的认可。如果其他等效产品具有相同的效果，则可使用这些等效的产品。

净容器。

## 7.2 试样前处理和提取

对不少于 50 g 或 50 mL 试样进行充分均质。固态类试样粉碎、研磨、过筛（筛板孔径 0.3 mm~0.5 mm）；半固态食品试样匀浆混匀；液态试样振摇混合均匀。

7.2.1 未经深加工及未经高温加热处理的食品（冰淇淋、葡萄酒、巧克力、沙拉酱等）：针对固态或半固态试样，称取 1.00 g 均质试样，加入 0.50 g 食品级脱脂奶粉（5.2.3），再加入 20 mL 预热至 60 °C 的 1×致敏原提取缓冲液（7.1.2）。针对液态试样，取 1 mL 均质试样，加入 0.50 g 食品级脱脂奶粉（5.2.3），再加入 19 mL 预热至 60 °C 的 1×致敏原提取缓冲液（7.1.2），按照 7.2.3 进一步处理试样。

7.2.2 经深加工或经高温加热处理的食品（面条、饼干等）：针对固态或半固态试样，称取 1.00 g 均质试样置于 50 mL 离心管中。加入 0.50 g 食品级脱脂奶粉（5.2.3）及 1 mL 蛋类致敏原提取剂（7.1.3），再加入 19 mL 预热至 60 °C 的含添加剂 1 的致敏原提取缓冲液（7.1.4）。针对液态试样，取 1 mL 均质试样置于 50 mL 离心管中。加入 0.50 g 食品级脱脂奶粉（5.2.3）及 1 mL 蛋类致敏原提取剂（7.1.3），再加入 18 mL 预热至 60 °C 的含添加剂 1 的致敏原提取缓冲液（7.1.4），按照 7.2.3 进一步处理试样。

7.2.3 将经过 7.2.1 或 7.2.2 处理后的试样，盖紧后涡旋混匀，然后置于 60 °C 水浴中孵育 10 min。用冰水快速冷却，再置冷冻离心机中在 4 °C 条件下以转速 4000 r/min 离心 10 min，取上清液进行检测。至此试样的稀释倍数为 20 倍。

## 7.3 测定

将预先包被蛋类致敏原特异性抗体的微孔（见附录 A）插入微孔板架并做好标记，标准溶液和试样均设置双平行。建议一次检测不要超过 3 条微孔板条（24 个板孔），以避免过大的孔间时间差造成对定量结果的不良影响。

在微孔中平行加入 100 μL 标准溶液 1~5（见附录 A）和试样溶液，室温（20 °C~25 °C）孵育 20 min。孵育结束后，弃去微孔中液体，每个微孔每次加入 250 μL 1×洗涤缓冲液（6.1.1）洗涤并在吸水纸上拍干，洗板 3 次。洗板结束后，每个微孔加入 100 μL 酶标记物（见附录 A），室温（20 °C~25 °C）孵育 20 min。孵育结束后，弃去微孔中液体，每个微孔每次加入 250 μL 1×洗涤缓冲液（7.1.1）洗涤并在吸水纸上拍干，洗板 3 次。洗板结束后，每个微孔加入 100 μL 底物/发色剂（见附录 A），轻轻地水平振板使其均匀混合，室温（20 °C~25 °C）下暗处避光孵育 10 min。孵育结束后，每个微孔加入 100 μL 终止液（见附录 A），轻轻地水平振板使其反应完全，在 450 nm 波长下 10 min 之内读取吸光度值（OD 值）。

## 7.4 标准曲线制作和测定结果计算

以标准溶液 2~5 质量浓度为横坐标，平行测定的标准溶液的平均 OD 值为纵坐标，绘制标准曲线，计算试样溶液中蛋类致敏原浓度（C）。

可以使用试剂盒配套分析软件 RIDASOFT® Win 中 4P 模式进行标准曲线绘制和测定结果计算。

## 7.5 测定结果表述

固态或半固态试样中蛋致敏原含量按式（1）计算：

$$X = \frac{C}{m \times 20} \times f \times V \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中：

$X$ ——试样中蛋致敏原含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

$C$ ——试样溶液中蛋致敏原浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

$f$ ——试样稀释倍数；

$V$ ——定容体积，为 0.02 L；

$m$ ——试样称量的质量，单位为 kg；

20——标准溶液浓度中包含的 20 倍稀释。

液态试样中蛋致敏原含量按式（2）计算：

$$X = C \times f \quad \dots\dots\dots(2)$$

式中：

$X$ ——试样中蛋致敏原含量，单位为毫克每升（mg/L）；

$C$ ——试样溶液中蛋致敏原浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

$f$ ——试样稀释倍数。

- 注： 1. 根据（7.2）制备的试样溶液时的 20 倍稀释倍数已经包括在标准曲线中，试样稀释倍数  $f$  只考虑除此 20 倍以外的稀释倍数。
2. 计算结果保留小数点后两位有效数字。

## 8 质量控制

### 8.1 试剂失效

出现以下情况之一表明试剂失效，不能进行测定或测定结果作废：

- 贮存在试剂瓶中的发色剂颜色出现蓝色；
- 加入终止液后标准溶液 5（2 mg/L）吸光度值 < 1.2。

### 8.2 变异系数

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于算术平均值的 10%。

## 9 检出限和定量限

本方法对全蛋粉的检出限为 0.13 mg/kg（L），定量限为 0.25 mg/kg（L）。

## 10 注意事项/防污染措施

### 10.1 防污染措施

10.1.1 食品试样的均质可能产生粉尘，为避免粉尘级别的蛋白（食品致敏原）污染应尽量在独立的房间或使用通风橱进行试样均质的前处理操作。

10.1.2 设备和器具用水冲洗后，用 60% 乙醇或异丙醇彻底清洁，以消除致敏原（蛋白质）污染。

10.1.3 在实验过程中必须戴手套操作，且在称量、均质试样，试样提取，及试剂盒检测三

个不同阶段中应更换新的手套。

## 第二法 免疫层析法

### 11 原理

试样中的蛋类致敏原与预包被在反应管内的标记抗体发生反应，形成抗原-抗体结合物。此抗原-抗体结合物被预包被在免疫层析试纸条上的特异性抗体捕获，形成抗体-抗原-抗体的夹心复合物，并在检测区显色，通过目测判读检测结果。

### 12 试剂和材料

#### 12.1 bioavid Lateral Flow Egg<sup>2</sup>蛋类致敏原免疫层析检测试剂盒

见附录 B。

#### 12.2 食品中蛋类致敏原提取试剂

除特别说明外，所有试剂均为分析纯或生化试剂，水为 GB/T 6682 规定的三级水。

12.2.1 PBS-Tween 缓冲液：8.00 g NaCl，0.20 g KCl，1.44 g Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>，0.24 g KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>，2 mL Tween-20，调 pH 至 7.2~7.4，用蒸馏水定容至 1 L。

12.2.2 氯化钠（NaCl）。

### 13 仪器和设备

13.1 分析天平：感量 0.01g。

13.2 匀浆机。

13.3 涡旋混匀仪。

13.4 离心机：转速不低于 4000 r/min。

13.5 单道移液器：100 μL~1000 μL，500 μL~5000 μL。

13.6 棉签拭子（无食品致敏原）。

### 14 分析步骤

#### 14.1 环境拭子的采样

14.1.1 吸取 1 mL PBS-Tween 缓冲液（12.2.1）到洁净的离心管中，浸润棉签拭子（13.6）。

14.1.2 用浸润的棉签拭子（13.6）的棉头充分擦拭 10 cm×10 cm 的待检测环境表面。若无法实现 10 cm×10 cm 的待检测环境表面擦拭，请自行定义合理及合适的待检测环境表面范围并记录。

<sup>2</sup> bioavid Lateral Flow Egg 是由 bioavid 公司提供的产品的商品名。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对该产品的认可。如果其他等效产品具有相同的效果，则可使用这些等效的产品。

14.1.3 将擦拭取样后的棉签拭子（13.6）放回装有 PBS-Tween 缓冲液（12.2.1）的离心管中，充分浸洗并挤压释放出棉签拭子（13.6）采样棉头上采集的试样（液）后，取出挤干的棉签拭子（13.6）。

14.1.4 从离心管中取 0.1 mL 用于检测。

注：若棉签采样拭子（13.6）上含有肉眼清晰可见的致敏原颗粒，或可能含有的致敏原浓度超过 1000 ppm（mg/kg），则建议将棉签拭子（13.6）采样处理后的离心管中试样液，进行例如 1:100 的进一步稀释后，再用于检测。

## 14.2 清洁用水的采样

直接取 0.1 mL 清洁用水用于检测。

## 14.3 食品试样前处理和提取

14.3.1 液态试样：对不少于 5 mL 试样进行均质。

14.3.2 固态或半固态试样：称取 50.00 g 试样，向其中加入 450 mL 水和 4.00 g 氯化钠（12.2.2）后均质。置离心机中于室温（20℃~25℃）条件以转速 4000 r/min 离心 5 min，取上清液用于检测。无离心条件时，可用粗滤纸过滤，得到滤清液用于检测。若离心后产生脂肪层，则轻挑除去脂肪层后，取脂肪层下的无脂肪清液用于检测。脂肪含量高的试样，建议进行冷冻离心以去除脂肪。

注：含有多酚类的试样如啤酒、葡萄酒、可可、调味料、中草药等需要使用 bioavid 吸附缓冲液进行试样处理。若试样中可能含有的致敏原浓度超过 1000 mg/kg，则建议将试样提取清液进行例如 1:100 的进一步稀释后，再用于检测。密封好的上清液/滤液可在 2℃~8℃黑暗处避光保存不超过 2 天。

## 14.4 试样的检测

向预包被标记抗体的反应管（见附录 B）中加入 0.2 mL 的流动相缓冲液（见附录 B），再加入 0.1 mL 于 14.1/14.2/14.3 步骤得到的试样提取液，盖上管盖，混合并室温（20℃~25℃）孵育 5 min。向反应管中放入蛋类致敏原试纸条（见附录 B）后反应 5 min，目测读取检测结果。

## 14.5 检测结果表述

试纸条同时出现蓝紫色质控带和蓝紫色检测带，检测结果为阳性。

试纸条只出现蓝紫色质控带，未出现蓝紫色检测带，检测结果为阴性。

试纸条上若有钩状效应带，则参考试纸条说明书上关于钩状效应带的结果评估方法。

## 15 质量控制

### 15.1 试剂失效

试纸条未出现蓝紫色质控带，检测结果无效。

### 15.2 内部质控

定期或必要时使用商品化加工食品中蛋类致敏原质控物或实验室自行制备的人工添加试样进行质量控制。



## 16 检出限

本方法对食品试样及清洁用水中蛋类致敏原（全蛋粉）的检出限为 1 mg/kg（L）。

本方法对环境表面的拭子采样的检出限为 1  $\mu\text{g}/100\text{ cm}^2$ （当采样面积为  $10\text{ cm}\times 10\text{ cm}$  时），或 1~3  $\mu\text{g}$ /采样拭子（当采样面积是自行确定时，并请明确所记录的采样范围）。

## 17 方法局限性

本文件的免疫层析方法适用于检测全蛋成分，纯蛋黄在较高浓度时才能得到阳性检测结果。当试样中蛋类致敏原含量  $\geq 1000\text{ mg/kg}$  时会发生钩状效应，检测带的颜色可能变浅甚至完全消失。

## 18 注意事项/防污染措施

### 18.1 防污染措施

按照 10.1

### 18.2 试样 pH 值

强酸性或强碱性试样应调节 pH 值至  $7.5\pm 0.5$  后再检测

附录 A

(规范性附录)

蛋类致敏原酶联免疫吸附检测试剂盒

A.1 试剂盒组成

蛋类致敏原酶联免疫吸附检测试剂盒 RIDASCREEN® Egg 包括：

- a) 预包被蛋类致敏原特异性抗体的 96 孔可拆分微孔板：8×12 孔；
- b) 酶标记物：11.0 mL/瓶×1 瓶；
- c) 10×洗涤缓冲液浓缩液：100 mL/瓶×1 瓶；
- d) 10×致敏原提取缓冲液浓缩液：100 mL/瓶×1 瓶；
- e) 提取剂 4：100 mL×1 瓶；
- f) 添加剂 1：2 g×1 瓶；
- g) ECO 环保添加剂：2.5 g×1 瓶；
- h) 标准溶液 1：1.3 mL/瓶×1 瓶，蛋类致敏原含量为 0.0 mg/L；
- i) 标准溶液 2：1.3 mL/瓶×1 瓶，蛋类致敏原含量为 0.25 mg/L；
- j) 标准溶液 3：1.3 mL/瓶×1 瓶，蛋类致敏原含量为 0.5 mg/L；
- k) 标准溶液 4：1.3 mL/瓶×1 瓶，蛋类致敏原含量为 1.0 mg/L；
- l) 标准溶液 5：1.3 mL/瓶×1 瓶，蛋类致敏原含量为 2.0 mg/L；
- m) 底物/发色剂：13 mL/瓶×1 瓶；
- n) 终止液：14 mL/瓶×1 瓶。

A.2 试剂盒验收和保存

- A.2.1 每个批号试剂盒应进行回收率测试的验收试验，回收率符合质量控制要求。
- A.2.2 试剂盒于 2℃~8℃ 黑暗处避光保存，使用前回复至室温（20℃~25℃）。
- A.2.3 不同批号试剂盒中组分不得混用。
- A.2.4 超过有效期的试剂盒不得使用。

A.3 标准曲线谱图

标准曲线谱图示例见图A.1。

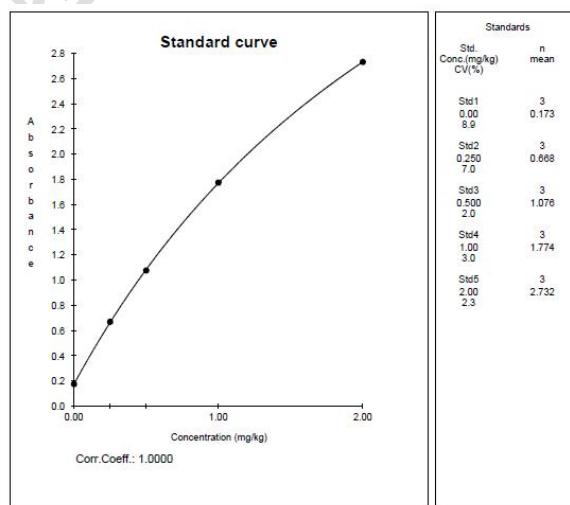


图 A.1 标准曲线谱图示例

## 附录 B

(规范性)

## 蛋类致敏原免疫层析检测试剂盒

## B.1 试剂盒组成

蛋类致敏原免疫层析检测试剂盒 bioavid Lateral Flow Egg 包括：

- a) 预包埋标记抗体的反应管：10 支或 25 支（根据试剂盒规格不同）；
- b) 蛋类致敏原快速检测条：10 支或 25 支（根据试剂盒规格不同）；
- c) 内含 10 mL 流动相（缓冲液）的滴瓶：1 支；
- d) 冻干阳性质控：1 份，使用时加入 1 mL 水复溶，涡旋混匀 5 min。

## B.2 试剂盒验收和保存

B.2.1 每个批号试剂盒应按照质量控制要求进行验收试验，考察检测性能。

B.2.2 未开封试剂盒保存在 $2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ ，使用前回复至室温（ $20^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ ）。开封后试剂条保存在室温（ $20^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ ）并保持干燥。

B.2.3 超过有效期的试剂盒不得使用。