

# 团 标 准

T/CIFST 004—2021

## 食品中维生素 B<sub>12</sub>的测定 预包被微孔板式微生物法

Determination of Vitamin B<sub>12</sub> in foods—  
Pre-coated microplate microbiological method

2021-08-23 发布

2021-08-23 实施

中国食品科学技术学会 发 布

## 前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件使用了与 AOAC Official Method 960.46 Vitamin Assays Microbiological Methods 和 GB 5413.14—2010《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素 B<sub>12</sub>的测定》中一致的菌种，提取方法类似。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国食品科学技术学会提出并归口。

本文件起草单位：广州海关技术中心、上海海关动植物与食品检验检疫技术中心、国家粮食和物资储备局科学研究院、拜发分析系统销售(北京)有限公司、杭州娃哈哈集团有限公司、石家庄君乐宝乳业有限公司。

本文件主要起草人：刘津、董洁、蔡一村、高东微、谢刚、王佳雅、廖冰君、葛丽花、贺丽丽、赵志红、张奕敏、柴艳兵、张耀广、李兴佳。

# 食品中维生素 B<sub>12</sub>的测定 预包被微孔板式微生物法

## 1 范围

本文件规定了食品中强化维生素 B<sub>12</sub>的预包被微孔板式微生物测定方法。

本文件适用于饮料、糖果、调制乳粉、婴儿配方食品、较大婴儿配方食品、幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、特殊医学用途配方食品、片剂、胶囊、粉剂型保健食品的强化维生素 B<sub>12</sub>含量的测定。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

## 3 原理

维生素 B<sub>12</sub>是预包被在微孔中的莱士曼氏乳酸杆菌(*Lactobacillus leichmannii*, ATCC 7830)生长所必需的营养素。在一定控制条件下,在维生素 B<sub>12</sub>测定培养基中,莱士曼氏乳酸杆菌的生长与待测试样中维生素 B<sub>12</sub>含量呈线性关系,根据吸光度值与标准工作曲线进行比较,即可计算出试样中维生素 B<sub>12</sub>的含量。

## 4 试剂和材料

4.1 预包被微孔板式维生素 B<sub>12</sub>微生物法试剂盒(VitaFast<sup>®</sup> Vitamin B<sub>12</sub>):见附录 A。

4.2 除非另有规定,本方法所用试剂均为分析纯,实验用水应符合 GB/T 6682 规定的二级水要求。

## 5 仪器和设备

5.1 水浴锅:95 ℃±1 ℃。

5.2 恒温培养箱:37 ℃±1℃。

5.3 均质器。

5.4 超净工作台。

5.5 离心机: $\geq 3\ 500\ g$ 。

5.6 酶标仪:波长 610 nm~630 nm 或 540 nm~550 nm。

5.7 涡旋混合器。

5.8 电子天平:感量 0.01 g。

5.9 微量可调单通道移液器及配套吸头:10 μL~100 μL、50 μL~200 μL、100 μL~1 000 μL。

5.10 无菌离心管:1.5 mL~2 mL、15 mL、50 mL。

- 5.11 锥形瓶:500 mL。
- 5.12 容量瓶:100 mL 和 1 000 mL。
- 5.13 无菌注射器:10 mL。
- 5.14 无菌聚醚砜滤膜(PES): $0.22\ \mu\text{m}$ 。

## 6 分析步骤

### 6.1 试样的制备

固体类试样需粉碎、研磨、过筛(筛板孔径 0.3 mm~0.5 mm);半固体食品试样应匀浆混匀;液体试样用前振摇混匀。

### 6.2 试样的提取

#### 6.2.1 饮料

对固体饮料准确称量 1.00 g 均质样品,对液体饮料移取 1 mL 样品至 50 mL 无菌离心管中,加水至 40 mL,涡旋混匀后,用无菌注射器和无菌聚醚砜滤膜对样品液进行无菌过滤至 2 mL 无菌离心管中。此为稀释倍数为 40 倍的样品液。

#### 6.2.2 糖果

称取 15.00 g ~ 20.00 g 糖果至 50 mL 无菌离心管中,加水至 40 mL,涡旋混匀后置 95 °C 水浴 30 min 溶解样品,期间颠倒混匀至少 5 次,确保离心管紧闭。水浴结束后冰浴迅速冷却到 30 °C 以下,将全部溶液转移至容量瓶中并定容至 100 mL。移取相当于 1.00 g 样品的溶液至 50 mL 离心管中(例如,取样量为 17.00 g,100 mL/17.00 g=5.88 mL/g,相当于 1.00 g 样品的体积为 5.88 mL),加水至 40 mL,涡旋混匀,用无菌注射器和无菌聚醚砜滤膜对样品液进行无菌过滤至 2 mL 无菌离心管中。此为稀释倍数为 40 倍的样品液。

#### 6.2.3 调制乳粉、婴儿配方食品、较大婴儿配方食品、幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、特殊医学用途配方食品

称量 1.00 g 均质样品至 50 mL 无菌离心管中,加水至 40 mL,涡旋混匀后置 95 °C 水浴 30 min,期间颠倒混匀至少 5 次,确保离心管紧闭。水浴结束后冰浴迅速冷却到 30 °C 以下,用无菌注射器和无菌聚醚砜滤膜对样品液进行无菌过滤至 2 mL 无菌离心管中。此为稀释倍数为 40 倍的样品液。

#### 6.2.4 片剂、胶囊、粉剂型保健食品

准确称量 1.00 g 均质后的片剂、胶囊或粉剂内容物至 500 mL 锥形瓶中,加入 400 mL 水混合均匀后置 95 °C 水浴 30 min,期间摇匀至少 5 次,水浴结束后冰浴迅速冷却到 30 °C 以下。将全部溶液转移至容量瓶中用水定容至 1 000 mL。取 1 mL 溶液至一个 50 mL 离心管中,加水至 40 mL,涡旋混匀,用无菌注射器和无菌聚醚砜滤膜对样品液进行无菌过滤至 2 mL 离心管中。此为稀释倍数为 40 000 倍的样品液。若维生素 B<sub>12</sub> 含量较低,可适当调整 1 000 mL 定容体积。

### 6.3 样品液的稀释

按照待测样品的标签值用无菌蒸馏水(见附录 A)进行适当的稀释,使样品液稀释后 B<sub>12</sub> 的含量落入标准曲线范围内。对样品液进行稀释时应逐级稀释,注意每次稀释不应大于 10 倍。

## 6.4 培养基的制备

用 10 mL 无菌蒸馏水(见附录 A)溶解测定维生素 B<sub>12</sub>的干粉培养基(见附录 A), 盖紧瓶盖, 涡旋振荡混匀。置 95 ℃水浴 5 min, 期间颠倒混匀至少 2 次。水浴结束后冰浴迅速冷却到 30 ℃以下。用无菌注射器和无菌聚醚砜滤膜对培养基进行无菌过滤至 15 mL 无菌离心管中待用, 现配现用。

## 6.5 标准稀释工作液的配制

根据标准品的标签说明, 在标准品中加入相应体积的无菌蒸馏水(见附录 A), 涡旋混匀得到标准品浓缩液。根据表 1 进行梯度标准稀释工作液的配制, 现配现用。

表 1 梯度标准稀释工作液的配制

编号	浓度 μg/100 g(mL)	配制方法
标准稀释工作液 0	0	900 μL 无菌蒸馏水 + 0 μL 标准品浓缩液
标准稀释工作液 1(Std 1)	0.03	900 μL 无菌蒸馏水 + 100 μL 标准品浓缩液
标准稀释工作液 2(Std 2)	0.06	400 μL 无菌蒸馏水 + 100 μL 标准品浓缩液
标准稀释工作液 3(Std 3)	0.09	350 μL 无菌蒸馏水 + 150 μL 标准品浓缩液
标准稀释工作液 4(Std 4)	0.12	300 μL 无菌蒸馏水 + 200 μL 标准品浓缩液
标准稀释工作液 5(Std 5)	0.18	200 μL 无菌蒸馏水 + 300 μL 标准品浓缩液

## 6.6 加样和培养

### 6.6.1 微孔板的取用

每个标准稀释工作液和待测样品都设置三平行, 取出所需数量的微孔板条并在微孔板架上固定, 未使用的微孔板条立即放回原来的箔袋中, 并与干燥剂一起重新封好, 储存在 2 ℃~8 ℃条件下。

### 6.6.2 培养基的移取

移取 150 μL 无菌过滤后的维生素 B<sub>12</sub>培养基至每个微孔中。

### 6.6.3 标准品和待测样品的移取

移取 150 μL 标准稀释工作液或待测样品液至微孔中, 记录每个微孔所加的标准品或待测样品的编号。

### 6.6.4 微孔板的密封

根据使用微孔板条的数量, 取出合适大小的黏合箔, 去除黏合箔的保护膜后平放在微孔条上, 用手将黏合箔平压, 使其充分封闭微孔, 特别注意微孔的边缘部分。

### 6.6.5 培养

将密封好的微孔板置于 37 ℃避光孵育 44 h~48 h。

### 6.6.6 测定

将微孔板倒置在桌面并紧贴桌面平行摇动, 使微孔中的液体混匀。将微孔板翻转孔口朝上静置

10 s 后,以对角线方向缓慢撕下黏合箔,撕下黏合箔时应注意用手按住微孔板条边缘防止因黏合箔带动微孔条而造成微孔中液体溅出。撕下黏合箔后仔细检查微孔中的液体,如有气泡应用枪头戳破或用移液器吸除。用酶标仪于 610 nm~630 nm 或 540 nm~550 nm 波长下读取吸光值。

## 7 标准曲线绘制、结果计算和结果表述

## 7.1 绘制标准曲线

计算梯度标准稀释工作液的三平行检测所测得的吸光值的算术平均值,结果保留三位有效数字。以梯度标准品维生素 B<sub>12</sub>含量做横坐标,以吸光值的平均值为纵坐标,使用 RIDA® SOFT Win 软件的四参数法绘制标准曲线。

## 7.2 结果计算

计算待测样品液的三平行检测所测得的吸光值的算术平均值,结果保留三位有效数字。在标准曲线中代入待测样品液吸光值的平均值,求得待测样品液中维生素 B<sub>12</sub> 的浓度。按照公式(1)求得待测样品中维生素 B<sub>12</sub> 的含量。

式中：

X ——待测样品中维生素 B<sub>2</sub>的含量,单位为微克每百克或微克每百毫升( $\mu\text{g}/100\text{ g}$  或  $\mu\text{g}/100\text{ mL}$ )。

$C_r$  ——待测样品液中维生素 B<sub>12</sub>的浓度,单位为微克每百克或微克每百毫升( $\mu\text{g}/100\text{ g}$  或  $\mu\text{g}/100\text{ mL}$ );

*m* ——待测样品的质量,单位为克(g);

40 ——40 的稀释倍数已经包括在标准曲线中;

$d$  ——稀释倍数。

V —— 定容体积, 40 mL.

**注 1:** 根据 6.2 制备样品液时的 40 倍稀释倍数已经包括在标准曲线中, 稀释倍数  $d$  只需考虑除此 40 倍以外的稀释倍数, 例如 6.2.3 中额外的 1 000 倍或 6.3 中的稀释倍数。

注 2：测亩结果保留小数点后两位有效数字

### 7.3 结果表述

7.3.1 若测定的是固体样品,维生素 B<sub>12</sub>含量的单位用  $\mu\text{g}/100\text{ g}$  表示;若测定的是液体样品,维生素 B<sub>12</sub>含量的单位用  $\mu\text{g}/100\text{ mL}$  表示。

7.3.2 若测定结果小于定量限  $0.03 \mu\text{g}/100 \text{ g(mL)}$ , 则待测样品中维生素 B<sub>12</sub> 含量测定结果表述为“<方法定量限”。

8 质量控制

8.1 标准稀释工作液 0 的吸光值应小于标准稀释工作液 1 的吸光值, 标准稀释工作液 5 的吸光值应大于 0.6, 否则表明实验失败。

8.2 标准曲线的相关系数不得低于 0.99。

### 8.3 三平行的变异系数不应大于 10%。

8.4 当待测样品液的吸光值小于标准稀释工作液 1 或大于标准稀释工作液 5 的吸光值时,不能使用标准曲线求得待测样品中维生素 B<sub>12</sub>的含量,应调整稀释倍数重新检测,使待测样品液的吸光值落在标准曲线的定量范围内。

8.5 不同批号试剂盒中组分不得混用,超过有效期的试剂盒不得使用。

## 9 检出限

本方法检测饮料检出限为  $0.021 \mu\text{g}/100 \text{ g}$ ,定量限为  $0.029 \mu\text{g}/100 \text{ g}$ ;检测糖果检出限为  $0.021 \mu\text{g}/100 \text{ g}$ ,定量限为  $0.028 \mu\text{g}/100 \text{ g}$ ;检测调制乳粉检出限为  $0.021 \mu\text{g}/100 \text{ g}$ ,定量限为  $0.027 \mu\text{g}/100 \text{ g}$ ;检测婴儿配方食品、较大婴儿配方食品、幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、特殊医学用途配方食品检出限为  $0.022 \mu\text{g}/100 \text{ g}$ ,定量限为  $0.031 \mu\text{g}/100 \text{ g}$ ;检测保健食品检出限为  $0.022 \mu\text{g}/100 \text{ g}$ ,定量限为  $0.032 \mu\text{g}/100 \text{ g}$ 。

## 附录 A

(规范性)

预包埋微孔板式维生素 B<sub>12</sub>微生物法检测试剂盒

## A.1 试剂盒组成

预包埋微孔板式维生素 B<sub>12</sub>微生物法检测试剂盒 VitaFast® Vitamin B<sub>12</sub> 包括：

- a) 包被有菌种 *Lactobacillus leichmannii* (ATCC 7830) 的微孔板: 12×8 孔;
- b) 无菌蒸馏水: 30 mL/瓶×3 瓶;
- c) 维生素 B<sub>12</sub> 标准品(固态): 3 瓶;
- d) 维生素 B<sub>12</sub> 测定培养基(干粉): 3 瓶;
- e) 黏合箔: 3 片;
- f) 微孔板架: 1 个。

## A.2 试剂盒验收和保存

A.2.1 每个批号试剂盒应进行验收试验, 验收需符合质量控制要求。

A.2.2 试剂盒于 2 ℃~8 ℃暗处避光保存, 使用前回复至室温, 使用后立即放回保存条件下。

A.2.3 不同批号试剂盒中组分不得混用。

A.2.4 超过有效期的试剂盒不得使用。

## A.3 标准曲线谱图

标准曲线谱图示例见图 A.1。

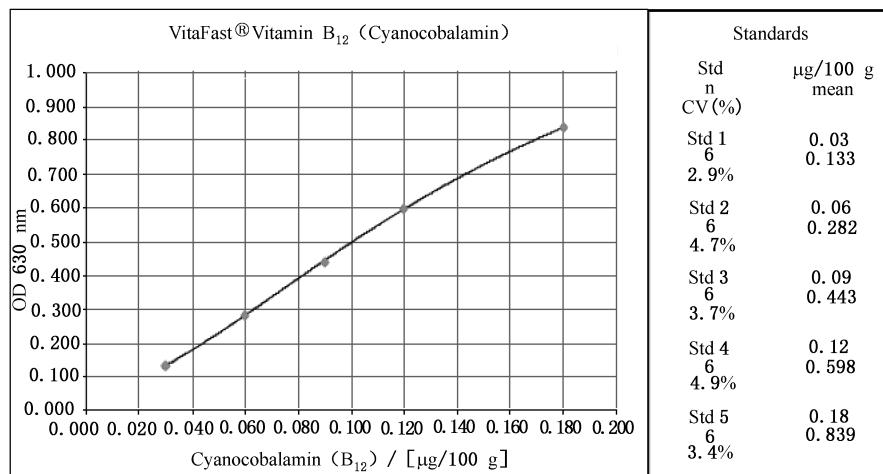


图 A.1 标准曲线谱图示例